

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Вычислители количества теплоты ВКТ-9

Назначение средства измерений

Вычислители количества теплоты ВКТ-9 предназначены для измерений выходных сигналов измерительных преобразователей параметров теплоносителя (расхода, температуры, давления) и вычислений по результатам измерений количества теплоносителя и тепловой энергии (количества теплоты) в водяных системах теплоснабжения, а также для измерений объема холодной воды, объема газа (в рабочих условиях), количества электроэнергии и температуры воздуха.

Описание средства измерений

Вычислители количества теплоты ВКТ-9 (в дальнейшем - вычислители) предназначены для работы:

1) с измерительными преобразователями параметров теплоносителя:

- счетчиками объема (преобразователями расхода, расходомерами) с импульсным выходным сигналом частотой до 16 Гц на пассивном выходе и до 1000 Гц на активном выходе при цене импульса от 0,001 до 10000 дм³;

- термопреобразователями сопротивления с номинальной статической характеристикой 100П, Pt100, 500П, Pt500, 1000П или Pt1000 по ГОСТ 6651-2009;

- преобразователями избыточного давления с верхним пределом измерений не более 2,5 МПа и выходным сигналом постоянного тока в диапазонах (0 – 5), (0 – 20) или (4 – 20) мА.

2) со счетчиками объема холодной воды, счетчиками газа и электроэнергии, с термопреобразователями сопротивления при измерениях температуры воздуха.

Модели вычислителей и их характерные особенности приведены ниже.

Модель	Количество подключаемых преобразователей по входу						Дополнительные входы для измерений		
	Тепловая система 1			Тепловая система 2			сопротивления	количества импульсов	
	ПР	ПТ	ПД	ПР	ПТ	ПД		ПТ	ПР
ВКТ-9-01	3	3	3	–	–	–	1		3
ВКТ-9-02	3	3	3	3	3	3	2		3

ПР – преобразователь расхода, ПТ – преобразователь температуры, ПД – преобразователь давления.

Вычислители обеспечивают представление текущих, часовых, суточных, месячных и нарастающим итогом показаний на встроенное табло и посредством интерфейсов RS232, USB и RS485 (опция по заказу) на внешнее устройство следующих величин:

- текущее время и дата;
- время работы и остановки счета количества теплоносителя и тепловой энергии;
- тепловая энергия и мощность;
- масса и объем теплоносителя;
- объемный и массовый расход теплоносителя;
- температура и разность температур теплоносителя;
- избыточное давление теплоносителя;
- количество и расход измеряемой среды (вода, газ, электроэнергия);
- температура холодной воды и воздуха.

Уравнения измерений (номинальные функции преобразования) тепловой энергии и массы воды, а также алгоритмы вычислений плотности и энтальпии воды соответствуют МИ 2412-97.

Вычислители имеют два дискретных входа и два дискретных выхода, соответственно предназначенных для приема и передачи информации о внешних событиях и нештатных ситуациях в работе вычислителя.

Хранение архивной и итоговой измерительной информации, а также диагностической и настроечной информации осуществляется в энергонезависимой памяти вычислителя.

Питание вычислителей осуществляется от литиевой батареи напряжение 3,6 В или от optionalного внешнего источника постоянного тока напряжением от 10 до 30 В с выходным током не менее 500 мА.

Вычислители выполнены в пластмассовом ударопрочном корпусе. Конструкция корпуса обеспечивает степень защиты IP54 или по заказу IP65 по ГОСТ 14254-96.

Внешний вид вычислителя приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид вычислителя

В целях предотвращения несанкционированного доступа к настройке вычислителя и к элементам его конструкции, предусмотрены места пломбирования, указанные на рисунках 1 и 2.

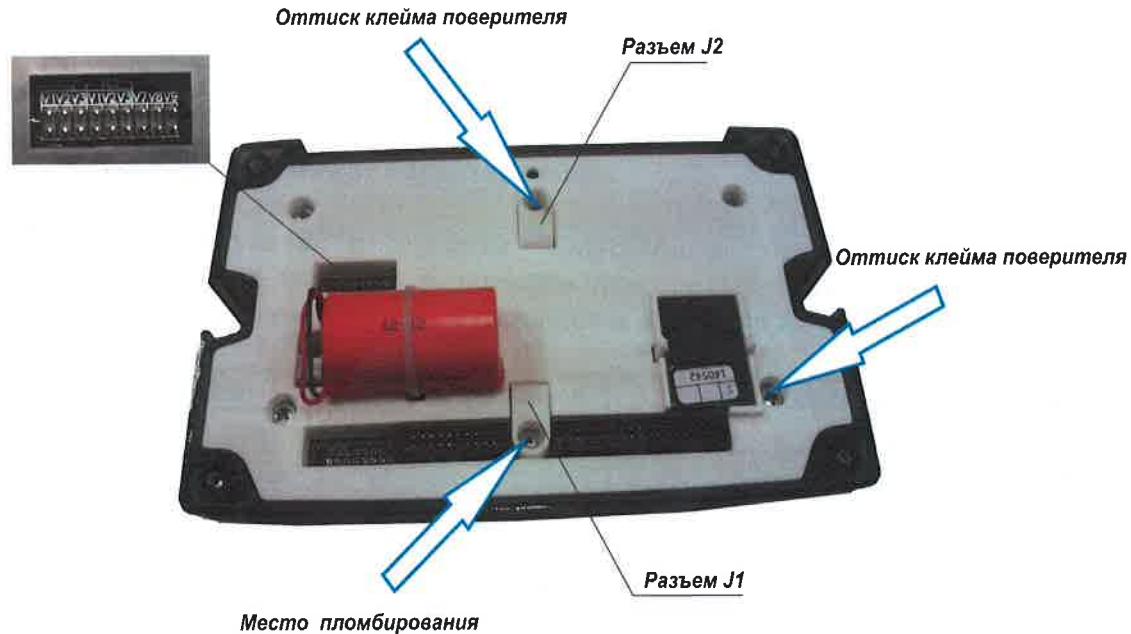


Рисунок 2 – Места пломбирования вычислителя

В целях обнаружения факта несанкционированных изменений в настройке вычислителя, предусмотрено вычисление и представление на табло и внешние устройства контрольных сумм, характеризующих калибровочные коэффициенты измерительных каналов и настроечные параметры рабочей базы вычислителя, а также ведение журнала событий с представлением информации на внешнее устройство.

Программное обеспечение

Вычислители имеют встроенное программное обеспечение (ПО), в котором выделена метрологически значимая часть.

Метрологически значимая часть ПО, отвечающая за алгоритмы вычислений измеряемых величин, обработки и представления результатов измерений, выполняет следующие функции:

- расчет значений расхода и количества измеряемой среды по результатам измерений выходных сигналов преобразователей расхода (счетчиков);
- расчет значений температуры и разности температур по результатам измерений выходных сигналов термопреобразователей сопротивления;
- расчет значений давления по результатам измерений выходных сигналов преобразователей давления;
- вычисление значений плотности, энталпии и разности энталпий воды по результатам измерений температуры, разности температур и давления;
- вычисление значений массового расхода и тепловой мощности по результатам расчетов объемного расхода и вычислений плотности и энталпии;
- вычисление значений массы и тепловой энергии по результатам расчетов объема и вычислений плотности, энталпии и разности энталпий.

Идентификационные данные ПО и его метрологически значимой части приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
-	VKT-9-01(02)	v01.XX	1039	CRC-16

XX – идентификатор метрологически незначимой части ПО, представленный двумя цифрами от 0 до 9.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – С по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений и пределы допускаемых значений погрешностей при преобразовании входных сигналов в значения измеряемых величин в рабочих условиях применения соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Величина	Диапазон	Пределы погрешности	Погрешность
Количество тепловой энергии, ГДж (Гкал)	0 – 10 ⁹	± (0,5 + 2/Δt) % ± (0,1 + 10/ΔΘ) %	относительная
Тепловая мощность, ГДж/ч (Гкал/ч)	0 – 10 ⁶	± (0,6 + 2/Δt) % ± (0,2 + 10/ΔΘ) %	
Масса, т	0 – 10 ⁹	± 0,1 %	относительная
Объем, м ³			
Количество электроэнергии, кВт·ч	0 – 10 ⁹	± 1 ед. мл. р.	абсолютная
Объемный расход, м ³ /ч			
Массовый расход, т/ч	0 – 10 ⁶	± 0,1 %	относительная
Электрическая мощность, кВт			
Температура, °C	-50 – +180	± 0,1 °C	абсолютная
Разность температур, °C	2 – 180	± (0,028 + 0,001Δt) °C	абсолютная

Избыточное давление, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)	$0 - 2,5$ ($0 - 25,49$)	$\pm 0,25 \%$	приведенная
Время работы и остановки счета, ч	$0 - 10^6$	$\pm 0,01 \%$	относительная
Δt – разность температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, $^{\circ}\text{C}$.			
$\Delta\Theta$ – разность температуры воды в трубопроводе и температуры холодной воды, принятой условно-постоянной величиной, $^{\circ}\text{C}$.			

Вычислители в рабочих условиях применения обеспечивают свои технические характеристики при воздействии на них следующих влияющих величин:

- температура окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до плюс 50 $^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 35 $^{\circ}\text{C}$;
- атмосферное давление в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;
- синусоидальная вибрация частотой (10 - 55) Гц с амплитудой смещения до 0,35 мм;
- напряженность магнитного поля частотой 50 Гц, не более 400 А/м.

Габаритные размеры вычислителей, не более, мм: длина – 200, ширина – 150, высота – 65.

Масса вычислителей не более 0,75 кг.

Средняя наработка на отказ 80000 ч.

Средний срок службы 12 лет.

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель вычислителя в виде наклейки и на титульный лист эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
Вычислитель количества теплоты	ВКТ-9	1	Модель и опции по заказу
Руководство по эксплуатации	РБЯК.400880.100 РЭ	1	
Паспорт	РБЯК.400880.100 ПС	1	
Методика поверки	РБЯК.400880.100 МП	1	

Проверка

осуществляется по документу РБЯК.400880.100 МП «Вычислители количества теплоты ВКТ-9. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 12 ноября 2013 г.

Основные средства поверки:

1. Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная Р3026-2. Диапазон сопротивлений ($0,01 - 111111,1$) Ом, класс точности $0,005/1,5 \cdot 10^{-6}$ – 2 шт.;
2. Магазин сопротивлений Р4831. Диапазон сопротивлений ($0,01 - 111111,1$) Ом, кт $0,02/2 \cdot 10^{-6}$;
3. Прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13. Диапазон постоянного тока от 100 нА до 100 мА, $\Pi\Gamma \pm 0,015$ мА;
4. Генератор импульсов Г5-79. Количество импульсов в серии от 1 до 9999 с дискретностью установки 1 имп., период повторения импульсов от 1 мкс до 99,9 с, длительность импульсов от 0,05 мкс до 0,999 с.
5. Стенд СКС6. Количество импульсов в серии – 16; постоянный ток 4 мА, $\Pi\Gamma \pm 0,003$ мА; 10 и 20 мА, $\Pi\Gamma \pm 0,009$ мА.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в руководстве по эксплуатации РБЯК.400880.100 РЭ «Вычислители количества теплоты ВКТ-9».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к вычислителям количества теплоты ВКТ-9:

1. ГОСТ Р 51649-2000. «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия».
2. ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011. «Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования».
3. Рекомендация МИ 2412-97. «Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя».
4. Рекомендация МИ 3286-2010. «Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа».
5. Технические условия ТУ 4217-100-15147476-2013. «Вычислители количества теплоты ВКТ-9».

Рекомендации по области применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

осуществление торговли и товарообменных операций.

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «НПФ Теплоком».

ЗАО «НПФ Теплоком».

195273, Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63, лит. А, оф. 222
т. 8-800-250-03-03, ф. (812) 703-72-00,
E-mail: welcome@teplocom-holding.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»,
190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14
e-mail: info@vniiim.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Ф.В. Булыгин

М.п.

2014 г.